

DESFIBRILADOR INTELIGENTE DE ACCESO PÚBLICO

*i*PAD CU-SP1





AJUSTE AUTOMÁTICO DE VOLUMEN

Algunos lugares públicos pueden ser ruidosos, estaciones abarrotadas, aeropuertos con anuncios constantes y calles llenas de coches y gente, a menudo dificultan escuchar lo que está pasando a nuestro alrededor.


Intentar usar un AED en lugares ruidosos puede ser difícil si la persona que maneja el desfibrilador no puede oír claramente los mensajes de voz e instrucciones desde el AED.

Para facilitar su audición el iPad CU-SP1 analiza el nivel de ruido ambiente, y automáticamente ajusta el volumen de los mensajes. Cuando se alcanza el volumen adecuado, el iPad CU-SP1 mantiene los mensajes a este nivel.



DETECCIÓN DE CPR

CPR es vital para asegurar que el paciente tiene las mayores oportunidades de sobrevivir. El iPAD CU-SP1 detecta si el CPR se está realizando siguiendo los mensajes y reanimaciones del usuario. Si no se está realizando el CPR, el iPAD CU-SP1 avisará al usuario para realizarlo. Si ya se está realizando, el iPAD CU-SP1 ayudará al usuario a completarlo.

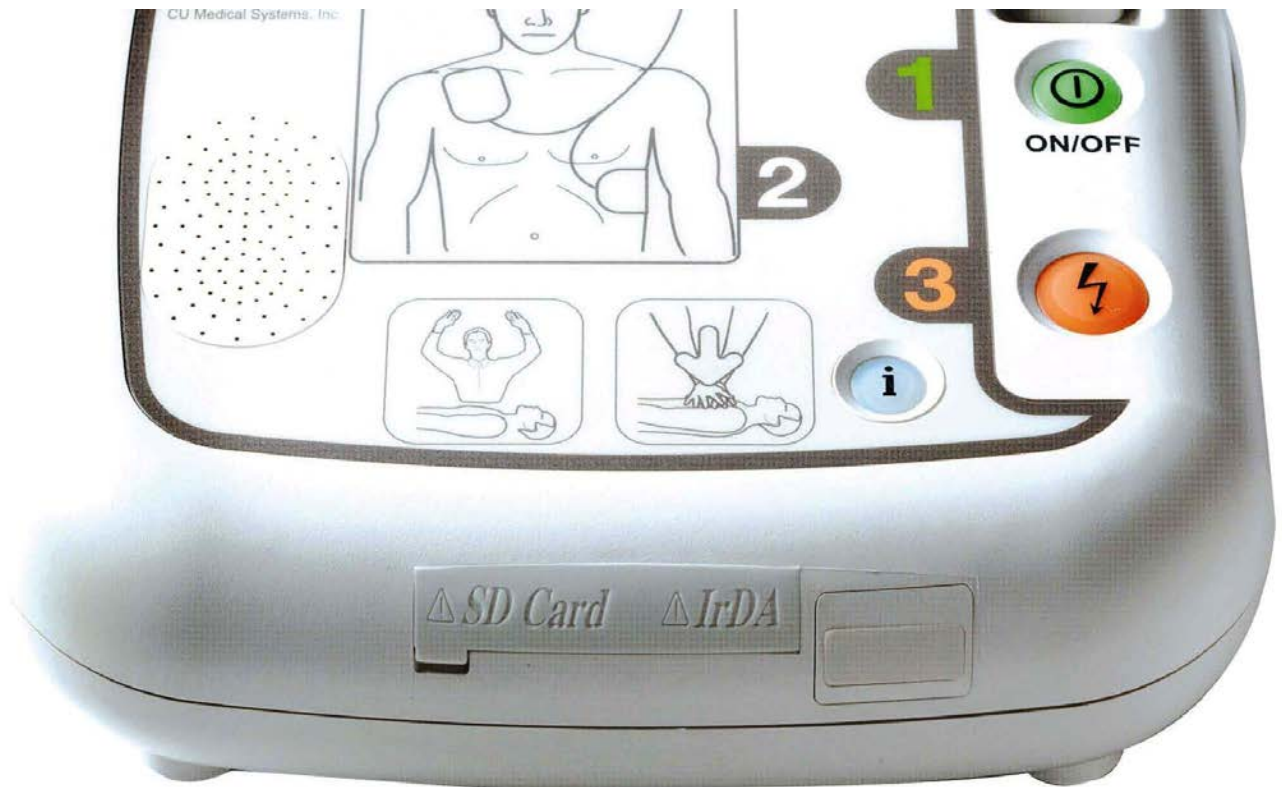

FÁCIL COMUNICACION CON EL SOFTWARE CU-EX1

Adquirir la información desde el iPad CU-SP1 después de un evento es ahora más fácil que nunca. Instalando el software CU-EX1 en su ordenador le permitirá ver y analizar el historial de uso del equipo. Información como el tiempo encendido, el ritmo cardiaco del paciente y las descargas suministradas se mostrarán en un formato fácil de entender.

El iPad CU-SP1 puede almacenar más de 5 eventos con más de 3 horas de análisis de ECG en una tarjeta de memoria SD. Los datos se pueden transferir simplemente o conectando la tarjeta SD a un PC o usando el puerto infrarrojos (IrDA). Tener los datos en una tarjeta de memoria SD permite usar estos datos para su análisis, mientras el equipo con otra SD insertada está preparado para su uso.

ESPECIFICACIONES CU-SP1

1. Desfibrilador

Modelo: CU-SP1

Contenido: Desfibrilador, electrodos, batería, manual

Energía de salida: Adulto-150Joules
Pediátrico-50Joules (uso común)

Tiempo de carga:

1) Tiempo de carga: Menor de 8 segundos

2) Tiempo de carga después de finalizado CPR: al menos 8 segundos

2. Interface de usuario

Ayuda al usuario: Mensajes de voz detallados e indicadores luminosos

Guía CPR: Mensajes por voz para realizar el CPR en pacientes adultos y niños.

Controles: Botón On/Off, botón I, Botón descarga

Indicador: Pantalla LCD

(Estado dispositivo, estado batería, estado de electrodos) Detección fecha caducidad electrodos, estado conexión electrodos

Ajuste volumen monitorización CPR automático

3. Entorno

Sellado: Protección líquidos IPX5 per IEC60529 (IP55) Protección polvo IP5X per IEC60529

Temperatura: Funcionamiento/standby (0°C - 40°C)

Vibración: Reúne directrices MILSTD 810F

4. Grabación de datos y transmisión

Puerto IrDA: Transmisión sin cables de datos de eventos al PC, Tarjeta SD

Memoria Interna (Nand-flash): ECG, Eventos

Capacidad de almacenaje: Multi grabación de 5 eventos/Max 3 horas

Programa PC revisión de datos: CU-EX1

5. Sistema análisis paciente

Análisis Paciente: Ritmos desfibrilables
Fibrilación ventricular
Taquicardia ventricular

Sensibilidad/Especificaciones: Reúne directrices AAMI DF80

6. Batería

Estándar:

* Tipo: DC 12 V 2.8 Ah, Lithium dióxido manganeso

* Capacidad: Mínimo 100 descargas (150J)

Alta capacidad:

* Tipo: DC 12V 4.2Ah, Lithium dióxido manganeso

* Capacidad: Mínimo 200 descargas (150J)

Vida útil: 5 años (Batería alta capacidad)

(En condiciones de temperatura de funcionamiento/standby y en modo standby después del chequeo inicial)

7. Electrodos

Uso común para adultos y niños

Fecha caducidad: 30 meses (desde la fecha de fabricación)